


Programa de Tecnovigilancia

Boletín segundo semestre 2021

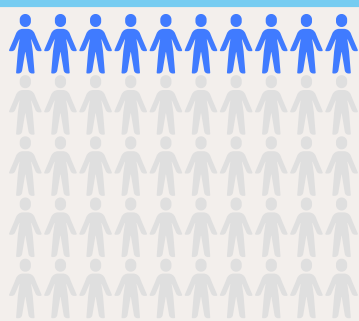

2 reportes

de incidentes adversos no serios asociados al uso de dispositivos médicos generados por la comunidad hospitalaria

CAPACITACIONES



III TRIMESTRE

Meta: 60%
Alcanzamos el 66% de cobertura en las capacitaciones



IV TRIMESTRE

Meta: 80%
Alcanzamos el 97% de cobertura en las capacitaciones

Indicador de cobertura



Gestión de alertas

Constantemente revisamos en la base de datos de Invima las alertas asociadas a *DM

No. alertas



279 alertas e informes de seguridad asociadas a DM* generó el Invima

Aplican



1 alerta de seguridad aplicaba a DM* usados en el hospital

Gestionadas



1 alerta de seguridad gestionada por completo

*DM= Dispositivos Médicos




Alerta No. 308-2021

Nombre del producto: Apósito con formula gel controlada Duoderm CGF

Los lotes referenciados por el Invima no correspondían a los lotes que se manejan en el hospital

LOGROS DEL COMITÉ



Se realizó el diagnóstico del grado de implementación del programa alcanzando un 66%



Se realizaron los reportes de incidentes y eventos adversos ante el Invima en los tiempos establecidos

Revisa todos los logros aquí:



← Recuerda reportar

Toda sospecha de evento o incidente adverso producido por dispositivos médicos